

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

PANAVIA V5 Standard Kit (Clear) Kuraray




Pret:

1.277,39 lei TVA inclusa

Descriere produs:

.....
.....
.....

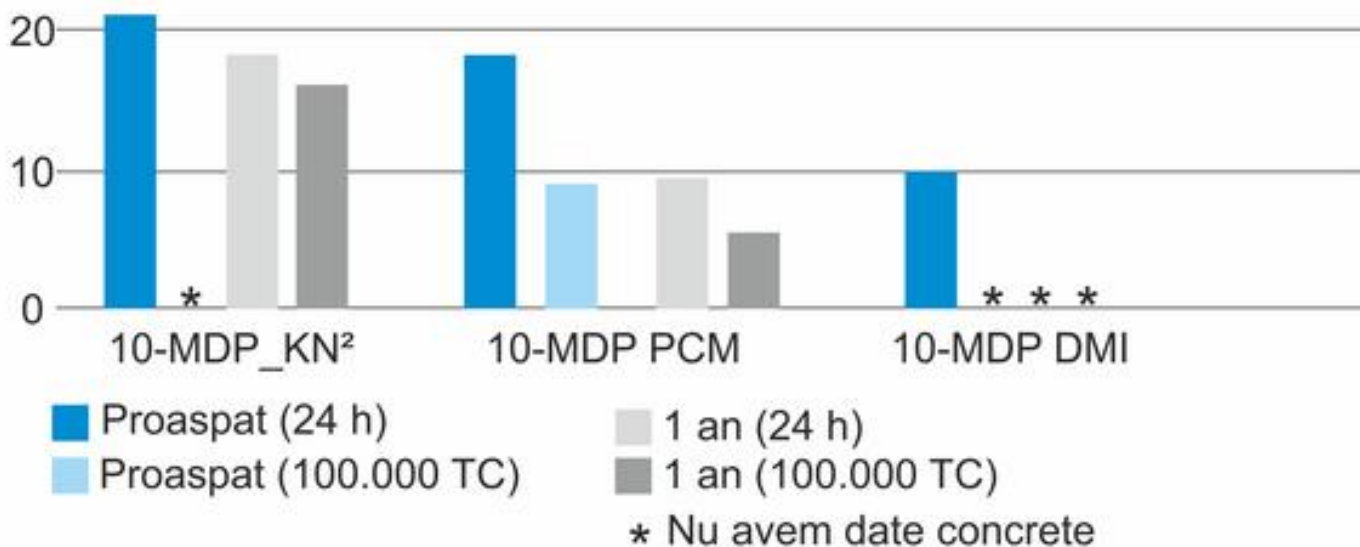


.....
.....

.....
.....

Stabilitate mai buna a culorii si fluorescenta, similara cu cea a dintilor naturali

Culoare stabila a cimentului

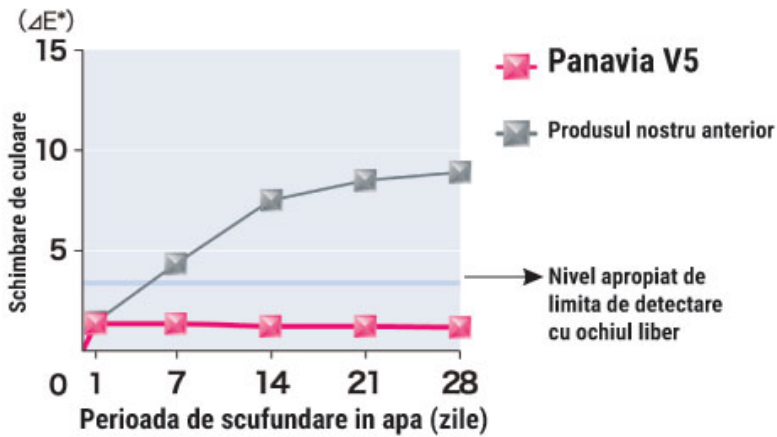

Condiții de măsurare:


Eșantionul de 0.25 mm grosime, a fost scufundat în apă (la 70°C) și apoi supus măsurării pe un fundal alb

Instrument de măsurare:

Spectrofotometru SE6000 (Nippon Denshoku), sursa de lumină: D65/2


Măsurat de Kuraray Noritake Dental Inc.: Valorile pot varia în funcție de condițiile de măsurare.

Fluorescenta asemanatoare cu cea a dintilor naturali

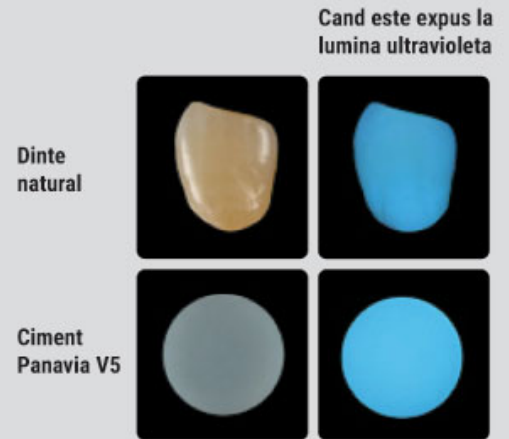


Fotografie de Kuraray Noritake Dental Inc.: Rezultatele pot varia în funcție de condițiile fotografice.

Cinci variante de culoare, inclusiv Universal

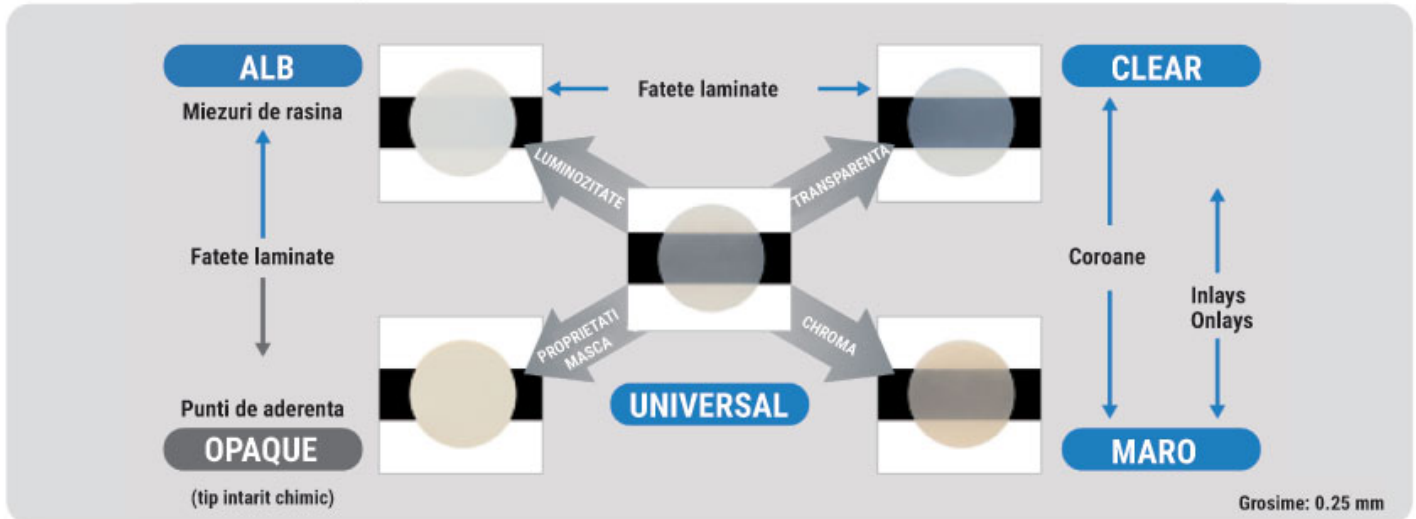


TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

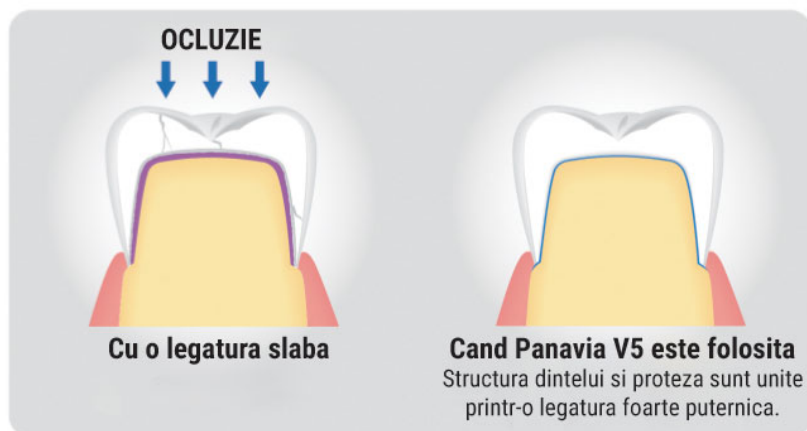

FORTA DE LEGARE DE STRUCTURA DINTELUI

Rezistenta de forfecare a dintelui uman
(dupa 3000 de cicluri termale)

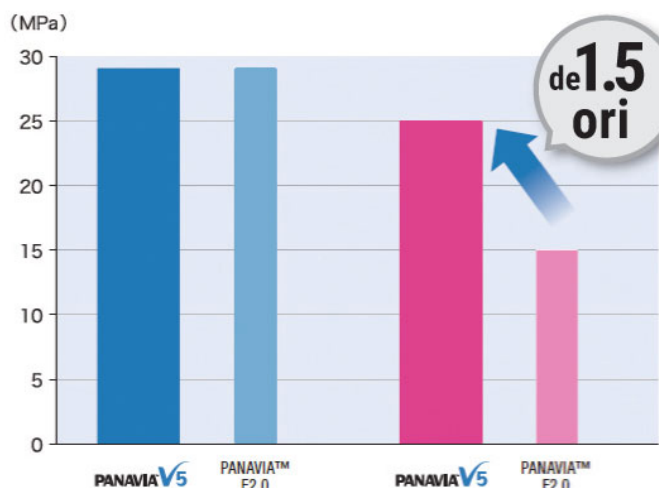

SMALT


DENTINA

Conditii de masurare:

Probele au fost dinți umani lustruiți cu granulație #1000 pentru o suprafață cu aderență de 3mm. Marginile lor au fost fotopolimerizate din două direcții folosind Pen Cure 2000 pentru 10 secunde fiecare. După întărire, au fost scufundate în apă la 37°C timp de o zi, supuse la un ciclu termal (4-60°C, de 3000 de ori (TC3000) sau de 4000 de ori (TC4000) și evaluate fie pentru rezistența la forfecare, fie pentru rezistența la tracțiune.

FORTA DE LEGARE DE STRUCTURA DINTELUI

Rezistența la tracțiune a dintelui bovin
(dupa 4000 de cicluri termale)

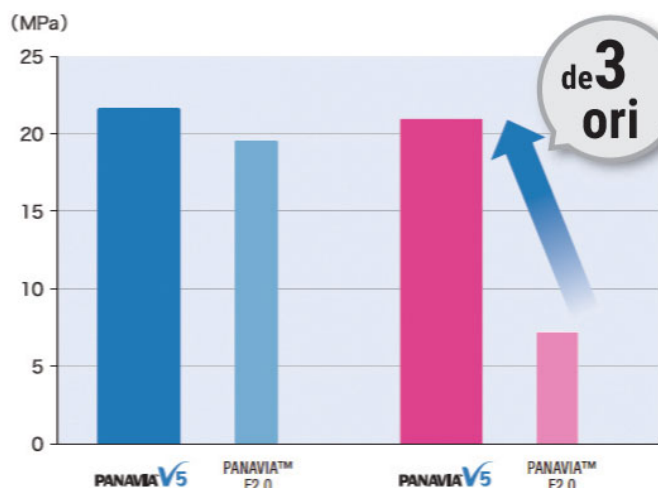

SMALT

DENTINA

Instrument de masurare:

Autograf AG-100kN (Shimadzu), viteza traversei de 1 mm/min (pentru testul de rezistență la forfecare) sau 2 mm/min (pentru testul de rezistență la tracțiune)

Măsurat de Kuraray Noritake Dental Inc.: Valorile pot varia în funcție de condițiile de măsurare.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....